

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO  
Catanzaro

Fornitura di apparecchiature radiologiche  
e lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento  
delle UU.OO. di Radiologia diagnostica e Radiologia d'urgenza  
presso i PP.OO. Pugliese e Ciaccio

TAV. N°

01

TITOLO ELABORATO



stato di fatto e proposta di dismissione  
piano primo

SCALA

PROGETTAZIONE  
Ufficio Tecnico AOPC

DATA

Novembre 2008

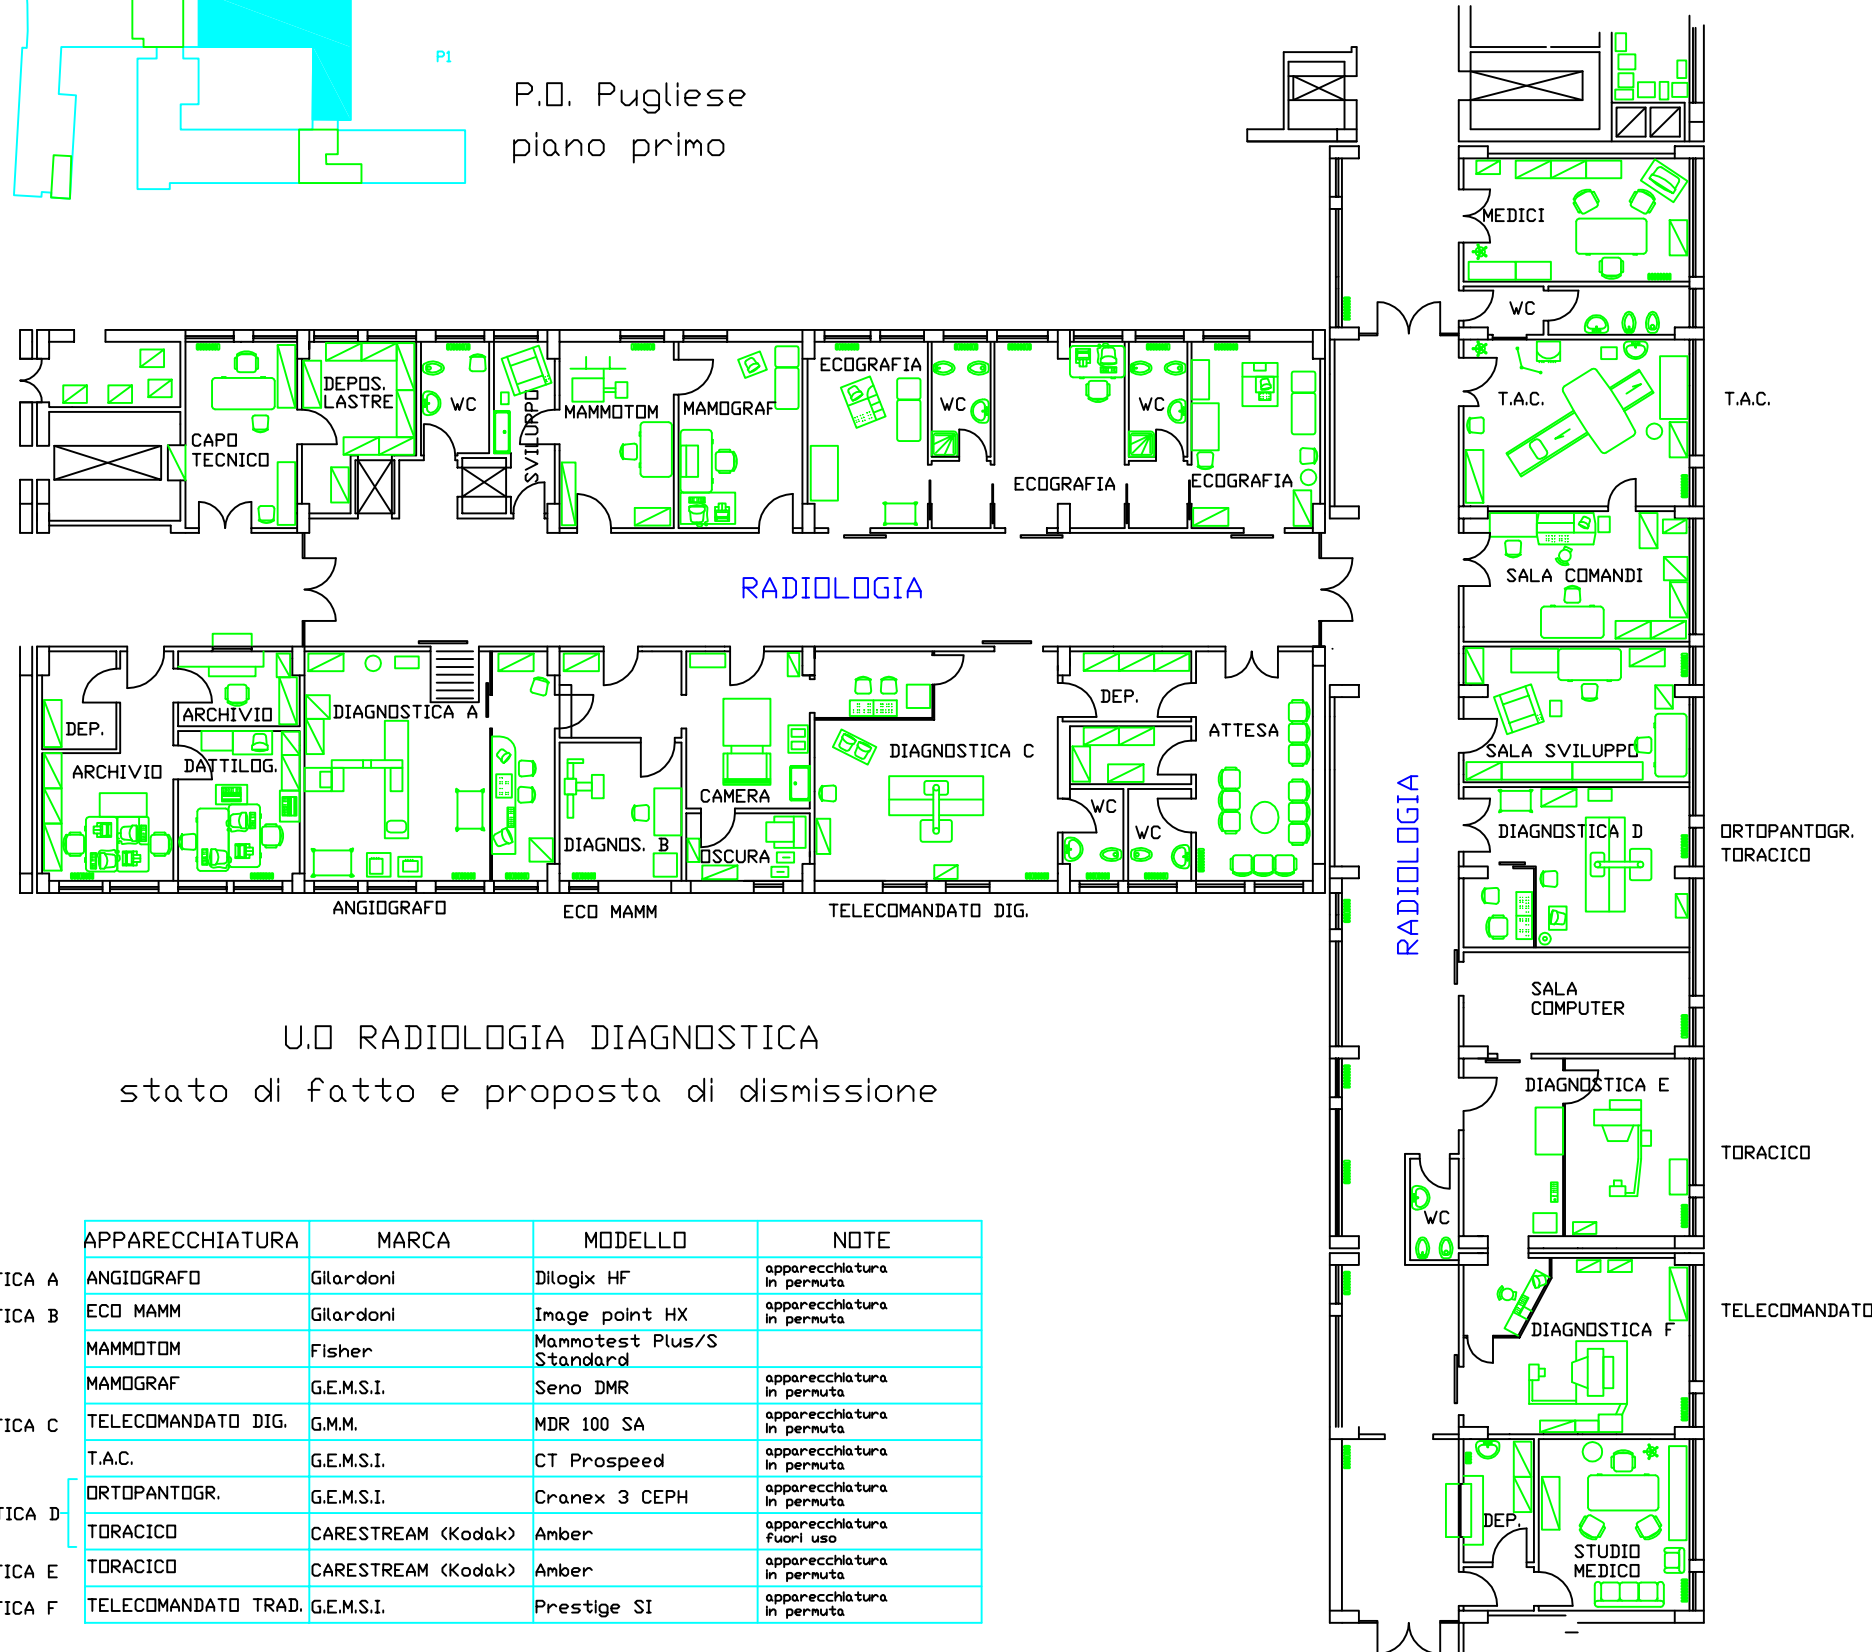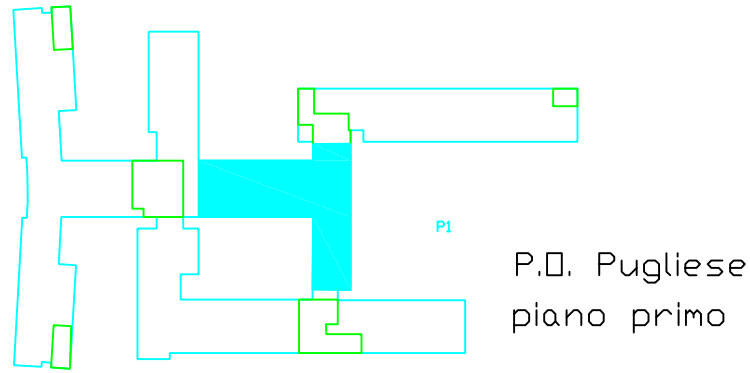

	APPARECCHIATURA	MARCA	MODELLO	NOTE
DIAGNOSTICA A	ANGIOGRAFO	Gilardoni	Dilogix HF	apparecchiatura in permuta
DIAGNOSTICA B	ECD MAMM	Gilardoni	Image point HX	apparecchiatura in permuta
	MAMMOTOM	Fisher	Mammotest Plus/S Standard	
	MAMMOGRAF	G.E.M.S.I.	Seno DMR	apparecchiatura in permuta
DIAGNOSTICA C	TELECOMANDATO DIG.	G.M.M.	MDR 100 SA	apparecchiatura in permuta
	T.A.C.	G.E.M.S.I.	CT Prospeed	apparecchiatura in permuta
DIAGNOSTICA D	ORTOPANTOGR.	G.E.M.S.I.	Cranex 3 CEPH	apparecchiatura in permuta
	TORACICO	CARESTREAM (Kodak)	Amber	apparecchiatura fuori uso
DIAGNOSTICA E	TORACICO	CARESTREAM (Kodak)	Amber	apparecchiatura in permuta
DIAGNOSTICA F	TELECOMANDATO TRAD.	G.E.M.S.I.	Prestige SI	apparecchiatura in permuta